



RCW-400A

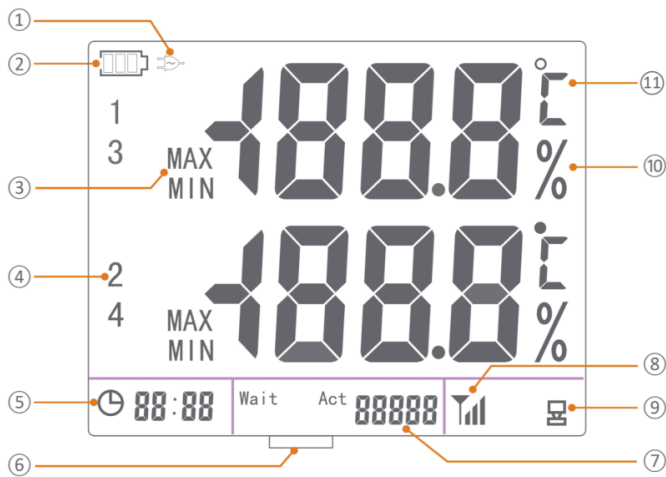

(1) 库狗电源接通指示	(2) 电池电量显示
(3) 超限报警指示: MAX-超上限报警 MIN-超下限报警	
(4) 探头序号	(5) 日期时间显示
(6) 记录状态指示: Wait-等待记录 Act-正在记录	
(7) 记录个数	(8) GSM 网络信号强度
(9) 4G/3G 网络连接平台信号指示	(10) 湿度单位
(11) 温度单位	

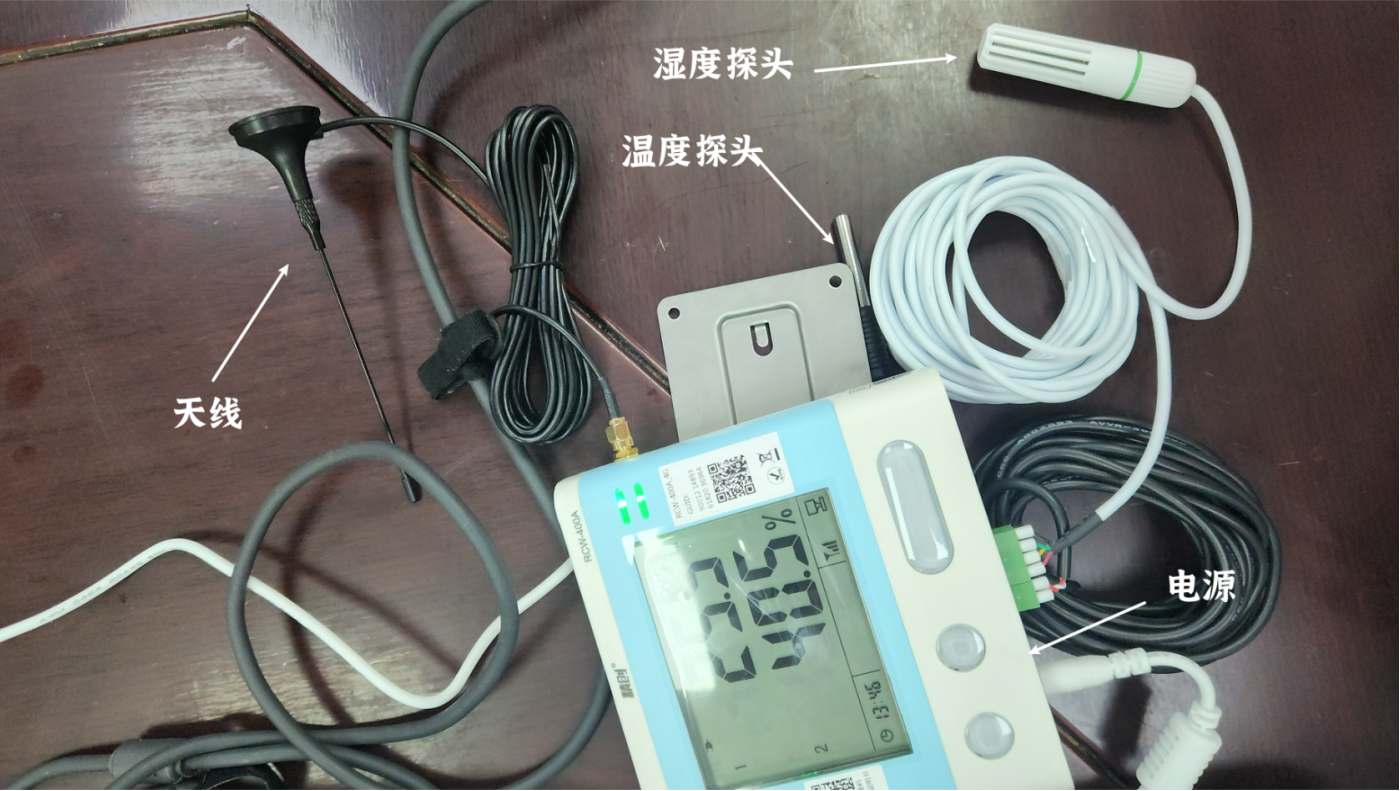

Web

<https://www.i-elitech.net/>GUID900121489361820369641

huatwofoldp1QAtpUQwKL8mtZyZMkA

精创冷云

首页

运营工作台

消息中心

设备管理

运营中心

资产管理

项目管理

组织管理

FDA 21 CFR

用户中心

数据中心

数据对接服务

校准服务

扫码添加您的设备专属标签

输入设备名称/型号/ID

搜索

冷链监测

设备名称

探头名称

测量值

深低温冰箱1

探头一值

25.5°C

RCW-400A_4.0

探头二值

43.8%RH

设备ID: 90012148936182036964

< 深低温冰箱1

停用

共享

允许快捷访问

更多操作

实时数据

数据图表

告警记录

推送配置

参数设置

地图

充值

基础信息

操作日志

维保记录

所有探头

探头一值

25.5°C

-10.0°C

50.0°C

Max 25.5°C

Min 25.1°C

2024-10-24 13:36:00

2024-10-24 13:40:00

2024-10-24 13:44:00

2024-10-24 13:48:00

2024-10-24 13:52:00

探头二值

43.8%RH

0%RH

50%RH

Max 59.2%RH

Min 41.6%RH

2024-10-24 13:36:00

2024-10-24 13:40:00

2024-10-24 13:44:00

2024-10-24 13:48:00

2024-10-24 13:52:00

APP



Revision #1
Created 24 October 2024 05:43:46 by
Updated 24 October 2024 05:56:45 by